

Phú Thọ, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ**

Kính gửi: .....

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cần **MÁY CẮT ĐÓT TAI MŨI HỌNG BẰNG TIA PLASMA** phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc với số lượng và chủng loại như sau:

**ĐVT: Đồng**

STT	Danh mục kèm thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Vnd)	Thành tiền (Vnd)
	<b>MÁY CẮT ĐÓT TAI MŨI HỌNG BẰNG TIA PLASMA</b>	Máy	1		
<b>Tổng cộng</b>					

(Phụ lục thông số và yêu cầu chi tiết kèm theo)

Điều kiện về báo giá: Giá chào hàng bao gồm thuế VAT.

\* Điều kiện giao hàng: Trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp đồng.

\* Điều kiện thanh toán: Sau khi kết thúc việc giao hàng giữa 02 bên và có biên bản nghiệm thu hàng hoá thực tế đã bàn giao. Bên mua sẽ tiến hành thanh toán cho bên bán trên cơ sở:

- Hoá đơn do bộ Tài chính phá thành theo số lượng hàng hoá thực cung cấp ghi trong biên bản nghiệm thu giữa 02 bên, trong đó ghi rõ danh mục hàng hoá, số lượng, đơn giá, thành tiền bằng VNĐ; Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hoá về số lượng và chất lượng; Biên bản thanh lý hợp đồng; Các hồ sơ liên quan khác (nếu có)


- Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc xin mời công ty gửi giấy báo giá (Nêu rõ đơn giá, tổng giá trị từng loại hàng, có đáp ứng các điều kiện giao hàng và thanh toán) hoặc gửi trực tiếp về phòng Vật tư- Trang thiết bị y tế Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc trước 15 giờ 00 ngày 30/03/2026.



Bệnh viện sẽ đánh giá và ký hợp đồng với các đơn vị có đủ khả năng cung cấp  
có báo giá được đánh giá là phù hợp nhất.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VT-TTBYT

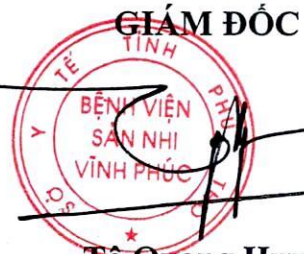

**Tô Quang Hưng**



## PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc ngày 23 tháng 03 năm 2026)

STT	Danh mục kèm thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Vnd)	Thành tiền (Vnd)
	<b>MÁY CẮT ĐÓT TAI MŨI HỌNG BẰNG TIA PLASMA</b> <i>Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm: .....</i> <b>Hãng sản xuất: .....</b> <b>Xuất xứ: .....</b> <b>Máy mới 100%, sản xuất 2025 -2026</b>	Máy	1		
	<b>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</b>				
	-Máy chính	Bộ	1		
	- Bàn đạp chân	Cái	1		
	- Bộ điều khiển lưu lượng	Bộ	1		
	- Cáp nối bộ điều khiển lưu lượng với máy chính	Cái	1		
	- Dây nguồn	Cái	1		
	- Tay dao plasma cho cắt amidal Ký mã hiệu: EI2302	Cái	15		
	- Tay dao plasma cho nạo VA Ký mã hiệu: EI2303	Cái	15		
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt	Bộ	1		
<b>I.</b>	<b>Thông tin chung</b>				
	- Năm sản xuất: Năm 2025 -2026, mới 100%.				
	- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485				
	- Nguồn cung cấp: Tương thích với nguồn điện 220V, 50Hz.				
	- Môi trường hoạt động:				
	+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30$ độ C				



	+ Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương				
<b>III.</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>				
	- Dao plasma tối thiểu cho các phẫu thuật: amidal, mũi, họng, thanh quản				
	- Chế độ hoạt động: Liên tục, ngắt quãng				
	- Chế độ làm việc, tối thiểu có: Cắt đốt và cầm máu				
	- Điều chỉnh được công suất cắt, cầm máu				
	- Điều chỉnh được thời gian cầm máu: 0 - 9 giây				
	- Công suất đầu ra tối đa: 300 W				
	- Nhiệt độ cắt đốt: 40 – 65°C				
	- Tần số cơ bản khoảng: 450 kHz				
	- Bàn đạp chân: + Điều khiển chế độ cắt và cầm máu + Tiêu chuẩn chống nước: IPX8				
	- Tay cắt đốt: <b>Tay dao plasma cho cắt amidal và Tay dao Plasma nạo V.A</b>				
	<b>Tổng cộng:</b> <b>Bằng chữ:</b>				

